


INVENTÁRIO DE TRANSIÇÃO

BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS

FEIRA DE SANTANA

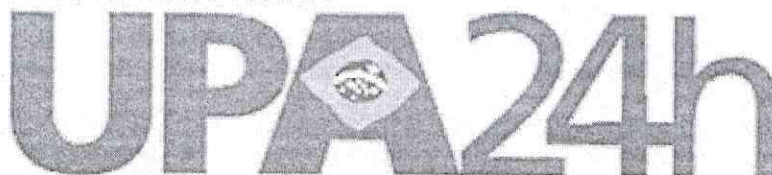

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA
(UPA) 24 HORAS

2024

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO / OBJETIVO DA VISITA TÉCNICA / METODOLOGIA	02/03
2	ANEXO I – RELAÇÃO DOS BENS BAIXADOS E AJUSTADOS	05
3	ANEXO II – RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS	08
4	ANEXO III – RELAÇÃO DOS BENS DE TERCEIROS	13
5	ANEXO IV – RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	15
6	ANEXO V – RELAÇÃO DOS BENS EM DESUSO	60
7	ANEXO VI – RELAÇÃO DOS BENS NÃO LOCALIZADOS	64
9	ANEXO VII – RELAÇÃO DOS BENS ANALITICOS - INCORPORADOS	66
8	ANEXO VIII – RELAÇÃO DOS BENS ANALÍTICOS DO INVENTARIO – SIAP	86

1. APRESENTAÇÃO

Cumprindo o cronograma do inventário de transição da Secretaria da Saúde do Estado – SESAB, Portaria nº 1.010 de 24 de outubro de 2024, publicado no Diário Oficial de 07 de novembro de 2024, entre o Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública - INTS e a Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde, que tem como fundamento o contrato de gestão nº 017/2024, que trata da operacionalização e Execução de Ações e dos Serviços de Saúde a serem desenvolvidas na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, situada no Município de Feira de Santana, Estado da Bahia, de propriedade da SESAB, intermediada pela Equipe Técnica da Coordenação de Patrimônio – COPAT, juntamente com os responsáveis pela empresa **INTS e a S3**, realizou a supervisão dos bens móveis e equipamentos no período de 04 a 11 de novembro de 2024.

2. OBJETIVO DA VISITA TÉCNICA

Inventariar os bens patrimoniais do **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS** – localizado na Av. Eduardo Fróes da Mota, s/n - 35º BI, Feira de Santana - BA, 44.094-00, de responsabilidade da **SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA – SESAB**, fazendo a transição da Gestão do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS para Associação de Proteção à Maternidade e à Infância Ubaíra - S3 Gestão em Saúde, situado à Rua Antônio Teixeira Della Cella, s/n, Centro, Ubaíra, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ sob o nº 14.284.483/0001-08, observando os bens patrimoniais existentes na Unidade, classificados em: bens da SESAB; bens em outras situações na referida Unidade

3. METODOLOGIA

O levantamento patrimonial foi realizado por meio de Visita Técnica a **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, pela equipe de trabalho, designada pela Diretoria Administrativa – DA, supervisionada pela Coordenadora do Patrimônio – Sra. Zorailde Martins de Oliveira e composta pelos técnicos da COPAT.

O trabalho foi dividido em duas etapas, sendo que a primeira etapa do trabalho, ocorreu utilizando o APP SIAP Mobile simultaneamente com notebook, efetuado pelos colaboradores da Coordenação de Patrimônio – COPAT, Sr. Ronilton Franklin Carvalho Barros e Wilson Santos de Oliveira e a segunda etapa ocorreram visando os ajustes do Inventário do Sistema SIAP.

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESAB
Mat. 19.318.338-6

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Zorailde Martins de Oliveira
2

A Equipe Técnica da COPAT, juntamente com as empresas citadas, através dos seus responsáveis Sr^a. **Izabel Cristina Ferrarezi Paim**, Supervisora de Patrimônio da INTS e o Sr. **Caio Vinícius Chaves Araújo**, Líder de hotelaria da **S3**, nos acompanhou nos trabalhos, no intuito de dar andamento às atividades do levantamento patrimonial da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**.

A supervisão utilizou as seguintes ferramentas de levantamento de dados e análise patrimonial:

- Conferência física dos bens;
- Conferência dos bens adquirido pelo contrato de gestão;
- Regularização e Ajuste, quando pertinente, de Bens no Sistema de Administração de Patrimônio – SIAP – Bens Móveis;

É relevante salientar que após análise e conferência dos materiais encontrados, buscou-se contabilizar todos os bens existentes na Unidade, adotando como referência o **Relatório Analítico de Bens Móveis**, emitido através do patrimônio da SAEB/SESAB. Os resultados estão apresentados em 02 (duas) partes, para fins de transparência e rastreabilidade.


A primeira parte envolve a apresentação da equipe, objetivo e metodologia do trabalho.

A segunda parte do relatório trata-se de conferência e análise dos bens adquiridos através da Secretaria da Saúde do Estado – SESAB. Apresentamos também os anexos com a descrição dos bens e as justificativas facilitando assim a análise comparativa entre o relatório SIAP e o levantamento dos bens existentes na Unidade, através dos anexos.

Salvador, 11 de novembro de 2024.


Sr^a. Priscila Luitza Oliveira de Souza
Diretora Administrativa / INTS

Sr^a. Fernanda Rodrigues
Diretora Institucional / S3


Sr^a. Izabel Cristina Ferrarezi Paim
Supervisora de Patrimônio / INTS



Sr. Caio Vinícius Chaves Araújo
Líder de Hotelaria / S3


Sr. Renilton Franklin Carvalho Barros

Sr. Wilson Santos de Oliveira
Técnicos da COPAT / SESAB


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

ANEXO


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESAI
Mat. 19.318.338-5


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009939






ANEXO I

RELAÇÃO DOS BENS SEM TOMBAMENTOS E AJUSTADOS

São bens que durante o levantamento e identificação, foram localizados sem as plaquetas de tombamento na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, os quais foram ajustados e colocados de etiqueta com código de barras, pela equipe da Copat e do patrimônio da empresa S3, durante a realização do inventário, até o envio das plaquetas oficiais confeccionadas pela SESAB, conforme anexo.


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT / SESAB
Mat. 19.318.338-6


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932


Raimundo


Manoel

RELAÇÃO DOS BENS SEM TOMBAMENTOS E AJUSTADOS

Itens	Descrição	Tombo Ajustados	Setor
1	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	343781	ADMINISTRATIVO
2	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	343786	ADMINISTRATIVO
3	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM TECDO	260170	ADMINISTRATIVO
4	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639610	ADMINISTRATIVO
5	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639611	ARQUIVO MEDICO
6	APARELHO NEGATOSCOPIO	470591	CENTRAL DE GAS
7	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM TECDO	260181	CLASSIFICACAO DE RISCO 2
8	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639609	CME
9	BELICHE EM ACO	625111	CONFORTO DE ENFERMAGEM
10	MESA PARA EXAME CLINICO	402867	CONSULTORIO 1
11	APARELHO NEGATOSCOPIO	297517	CONSULTORIO 2
12	APARELHO NEGATOSCOPIO	470593	CONSULTORIO 3
13	MESA PARA EXAME CLINICO	402865	CONSULTORIO 4
14	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639606	CONSULTORIO 4
15	APARELHO NEGATOSCOPIO	396293	CONSULTORIO 5
16	BANQUETA GIRATORIA	379335	CONSULTORIO 6
17	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA	332361	CONSULTORIO 6
18	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	639608	CONSULTORIO 6
19	MACA DE TRANSPOSICAO	349156	CORREDOR AMBULATORIO
20	CARRO MACA REFORCADO	345630	CORREDOR
21	CADEIRA DE RODAS OTTOBOCK	343832	CORREDOR SL. DE GESSO
22	BANQUETA GIRATORIA EM COURVIR	336361	CURATIVO
23	SUPORTE PARA SORO	667051	CURATIVO
24	LARIGOSCOPIO ADULTO	408871	CURATIVO
25	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM COUVIR	377435	DIRECAO
26	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA	332359	ENFERMEIRO LIDER
27	OTOSCOPIO - MD	327386	ENFERMEIRO LIDER
28	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM COURVIM	500093	ENFERMEIRO LIDER
29	LONGARINA DE 03 LUGARES	344213	ENTRADA DE AMBULANCIA
30	MACA HOSPITALRA COM 2 MANIVELAS	345622	ENTRADA DE AMBULANCIA
31	MACA HOSPITALRA COM 2 MANIVELAS	345625	ENTRADA DE AMBULANCIA
32	SERRA DE GESSO	639613	FARMACIA
33	FRIGOBAR - MIDEIA	639612	FARMACIA
34	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA	332355	FARNACIA CAF
35	CADEIRA GIRATORIO SEM BRACO	639607	FARNACIA CAF
36	MACA HOSPITALRA COM 2 MANIVELAS	345627	ISOLAMENTO AMBULATORIO
37	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639614	LASSIFICACAO DE RISCO 4
38	BANQUETA GIRATORIA EM ACO	379336	MANUTENCAO
39	CONTAINER PARA COLETA DE RESIDUO	673849	MANUTENCAO EXTERNA
40	BANQUETA PARA PARTO HUMANIZADO	336363	NEBOLIZACAO
41	BIOMBO SANFONADO	678795	NEBOLIZACAO
42	MESA DE MAYO	345122	NEBOLIZACAO
43	MESA DE MAYO	345124	NEBOLIZACAO
44	MESA DE MAYO INOX	681488	NEBOLIZACAO
45	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA	332351	NEBOLIZACAO
46	CADEIRA GIRATORA SEM BRACO EM CORVIN	500584	NEBOLIZACAO
47	CADEIRA GIRATORA SEM BRACO EM CORVIN	500100	NEBOLIZACAO

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESAB
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat. 009937

Flavio Paim

João M

48	OXIMETRO DE DEDO	496810	NEBOLIZACAO
49	MESA DE MAYO INOX	681487	NUCLEO DE MANUTENCAO
50	CADEIRA DE RODAS OTTOBOCK	343830	NUCLEO DE MANUTENCAO
51	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639601	NUCLEO DE MANUTENCAO
52	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639602	NUCLEO DE MANUTENCAO
53	CAMA TIPO FAWLER - MOVEIS ANDRADE	344907	OBS. ADULTO
54	CAMA TIPO FAWLER - MOVEIS ANDRADE	344909	OBS. ADULTO
55	LARINGO ADULTO	408872	OBS. ADULTO
56	MESA DE CABECEIRA	457710	OBS. ADULTO ISOL. MASC.
57	SUPORTE PARA SORO	263598	OBS. ADULTO ISOL. MASC.
58	MACA HOSPITALRA COM 2 MANIVELAS	345623	OBS. PEDIATRICA
59	MESA DE CABECEIRA	457562	OBS. PEDIATRICA
60	MESA DE MAYO	345123	OBS. PEDIATRICA
61	MESA PARA EXAME CLINICO	402862	OBS. PEDIATRICA
62	SUPORTE PARA SORO	263596	OBS. PEDIATRICA
63	SUPORTE PARA SORO	263597	OBS. PEDIATRICA
64	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM COUVIR	500094	OBS. PEDIATRICA
65	LARINGO INFANTIL	408873	OBS. PEDIATRICA
66	TELEVISOR 55 - PHILIPS	703600	REFEITORIO
67	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM TECIDO	246746	SERVICO SOCIAL
68	MESA PARA EXAME CLINICO EM COUVIM	402868	SL. DE GESSO
69	SUPORTE PARA SORO	263600	SL. DE MEDICACAO
70	MACA HOSPITALRA COM 2 MANIVELAS	345624	SL. VERMELHA
71	SUPORTE PARA SORO	263599	SL. VERMELHA
72	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639603	SL. VERMELHA
73	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM TECIDO	639605	SL. VERMELHA
74	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA	332364	SUPRIMENTO
75	VENTILADOR LESTUNG - SERIE: G18069	408407	SL. VERMELHA

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Tecnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESAB
Mat. 19.818.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat. 009932

Elisio Paim

Loio MP

ANEXO II

RELAÇÃO DOS BENS INCORPORADOS

Trata – se de bens materiais e equipamentos que foram incorporados a carga patrimonial da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, no período da transição.


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico de COPAT - SFSP
Mat. 18.318.338-6


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009937


Luiz Felipe

Luis

RELAÇÃO DOS BENS PARA INCORPORAR INTS

ITENS	PATRIMONIO	DESCRIÇÃO DO BEM	SETOR
1	740433	RACK EM AÇO COM PORTA DE VIDRO	ADMINISTRATIVO
2	740434	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	ADMINISTRATIVO
3	740435	ESTANTE EM AÇO	ADMINISTRATIVO
4	740436	SERVIDOR HP	ADMINISTRATIVO
5	740437	MICROCOMPUTADOR TIPO SERVIDOR C3TEC	ADMINISTRATIVO
6	740438	SWITCH TNET 24 PORTAS	ADMINISTRATIVO
7	740439	SWITCH TNET 24 PORTAS	ADMINISTRATIVO
8	740440	SWITCH TNET 24 PORTAS	ADMINISTRATIVO
9	740441	MICROCOMPUTADOR LENOVO	ADMINISTRATIVO
10	740442	MICROCOMPUTADOR	ADMINISTRATIVO
11	740443	MICROSCOPIO GLOBAL	LABORATORIO
12	740444	CONTADOR DE CELULAS	LABORATORIO
13	740445	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA PRETA	LABORATORIO
14	740446	HOMOGENIZADOR DE SANGUE	LABORATORIO
15	740447	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS CEREJEIRA	LABORATORIO
16	740448	IMPRESSORA ZEBRA	LABORATORIO
17	740449	MICRO COMPUTADOR	LABORATORIO
18	740450	MICROSCOPIO BIOFOCUS	DEP. LABORATORIO
19	740451	ARQUIVO PARA PASTA SUSPensa	ARQUIVO MEDICO
20	740452	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
21	740453	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
22	740454	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
23	740455	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
24	740456	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
25	740457	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
26	740458	ESTANTE EM AÇO	ARQUIVO MEDICO
27	740459	MICRO COMPUTADOR LENOVO	ARQUIVO MEDICO
28	740460	MICRO COMPUTADOR NEWDRIVE	ARQUIVO MEDICO
29	740461	ESTANTE EM AÇO	DML DIRETORIA
30	740462	ESTANTE EM AÇO	DML DIRETORIA
31	740463	CADEIRA ALTA TIPO CAIXA	FARMÁCIA SATÉLITE
32	740464	ESTANTE EM MADEIRA	SUPRIMENTO
33	740465	MESA DE TRABALHO EM L	SUPRIMENTO
34	740466	MICRO COMPUTADOR LENOVO	SUPRIMENTO
35	740467	MICRO COMPUTADOR SEM MARCA	SUPRIMENTO
36	740468	MICRO COMPUTADOR ELGIN	SUPRIMENTO
37	740469	ARMARIO BAIXO EM MADEIRA COM 02 PORTAS	COPA
38	740470	ARMARIO EM COM 06 PORTAS	COPA
39	740471	ARMARIO SUSPENSO EM AÇO C/ 03 PORTAS	COPA
40	740472	CADEIRA FIXA SEM BRACOS EM TECIDO	COPA
41	740473	ARMARIO BAIXO CONFECCIONADO COM TAMPO DE MARMORE	REFEITORIO

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico de COPAT - SCS
Mat. 19.318.338-1

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Guilherme Faria
Luis AP

42	740474	ARMARIO VESTIARIO COM 12 PORTAS	CORREDOR
43	740475	ARMARIO VESTIARIO COM 12 PORTAS	CORREDOR
44	740476	ARMARIO VESTIARIO COM 12 PORTAS	CORREDOR
45	740477	ARMARIO VESTIARIO COM 12 PORTAS	CORREDOR
46	740478	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA	ALMOXARIFADO
47	740479	ESTANTE EM ACO	ALMOXARIFADO
48	740480	ESTANTE EM ACO	ALMOXARIFADO
49	740481	ESTANTE EM ACO	ALMOXARIFADO
50	740482	CADEIRA GIRATORIA COM BRACOS EM TECIDO	ARQUIVO MEDICO
51	740483	CADEIRA GIRATORIA COM BRAÇOS EM POLIPROPILENO NA COR AZUL	DEP. PESSOAL
52	740484	MESA DE TRABALHO EM MADEIRA	DEP. PESSOAL
53	740485	IMPRESSORA HP , MULTIFUNCIONAL	DEP. PESSOAL
54	740486	ESTANTE EM ACO COM 06 PRATELEIRAS	DEP. PESSOAL
55	740487	ARMARIO ALTO EM ACO C/ 02 PORTAS	CORREDOR VESTIARIO
56	740488	BELICHE EM MADEIRA	CONFORTO 3
57	740489	BELICHE EM MADEIRA	CONFORTO DE ENFERMAGEM
58	740490	BELICHE EM MADEIRA	CONFORTO DE ENFERMAGEM
59	740491	BELICHE EM MADEIRA	CONFORTO DE ENFERMAGEM
60	740492	BELICHE EM MADEIRA	CONFORTO DE ENFERMAGEM
61	740493	ARMARIO VESTIÁRIO COM 08 PORTAS PANDIN	CONFORTO MEDICO
62	740494	BELICHE TUBULAR BRANCO	CONFORTO MEDICO
63	740495	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA	CONFORTO MEDICO
64	740496	CAMA DE SOLTEIRO EM MADEIRA	CONFORTO MEDICO
65	740497	TELEVISOR 32 - LG	CONFORTO MEDICO
66	740498	REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL MARCA ELECTROLUX	CONFORTO MEDICO
67	740499	BANCO DE ESPERA ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO EM MADEIRA	SANITARIO FEMININO
68	740500	BANCO DE ESPERA ESTRUTURA EM AÇO, ASSENTO EM MADEIRA	SANITARIO MASCULINO
69	740501	ARMARIO ALTO EM ACO C/ 02 PORTAS	CME
70	740502	ARMARIO SUSPENSO EM ACO C/ 02 PORTAS ITATIAIA	CME
71	740503	CADEIRA FIXA SEM BRACO TECIDO PRETO	CME
72	740504	IMPRESSORA TERMICA	FARMÁCIA CAF
73	740505	IMPRESSORA TERMICA	FARMÁCIA CAF
74	740506	IMPRESSORA TERMICA	FARMÁCIA CAF
75	740507	MICRO COMPUTADOR LENOVO	FARMÁCIA CAF
76	740508	MICRO COMPUTADOR NEWDRIVER	FARMÁCIA CAF
77	740509	PURIFICADOR DE AGUA	CORREDOR PEDIATRIA
78	740510	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	CORREDOR PORTARIA
79	740511	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CORREDOR PORTARIA	CLASSIFICACAO DE RISCO 2
80	740512	MICRO COMPUTADOR LENOVO	CLASSIFICACAO DE RISCO 2
81	740513	CADEIRA FIXA EM POLIPROPELENO	CLASSIFICACAO DE RISCO 1
82	740514	MICRO COMPUTADOR LOGIN	CLASSIFICACAO DE RISCO 1
83	740515	MICRO COMPUTADOR	NEBOLIZACAO
84	740516	BALANCA PEDIATRICA - BALMACK	CASSIFICACAO DE RISCO 1
85	740517	ARMARIO BAIXO 02 PORTAS COM RODIZIOS	CONSULTORIO 6
86	740518	MICRO COMPUTADOR NEWDRAVE	CONSULTORIO 6

Ronilton Franklin C. Barros
Cach. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESAU
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Paulo Faim
10
Lócio Anp

87	740519	MICRO COMPUTADOR LOGIN	CONSULTORIO 1
88	740520	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	CONSULTORIO 1
89	740521	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO COR AZUL	CONSULTORIO 2
90	740522	IMPRESSORA – BROTHER	CONSULTORIO 2
91	740523	CADEIRA DE POLIPROPILENO	CONSULTORIO 5
92	740524	IMPRESSORA LAZER - HP	CONSULTORIO 5
93	740525	MICRO COMPUTADOR LENOVO	CONSULTORIO 5
94	740526	CADEIRA FIXA EM POLIPROPELENO	CONSULTORIO 4
95	740527	IMPRESSORA CANON	CONSULTORIO 4
96	740528	MICROCOMPUTADOR LOGIN	CONSULTORIO 4
97	740529	CADEIRA DE POLIPROPILENO	CONSULTORIO 3
98	740530	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	CONSULTORIO 3
99	740531	IMPRESSORA CANON	CONSULTORIO 3
100	740532	MICRO COMPUTADOR LOGIN	CONSULTORIO 3
101	740533	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	SL. VERMELHA
102	740534	MICRO COMPUTADOR - LOGIN	SL. VERMELHA
103	740535	IMPRESSORA HP	SL. VERMELHA
104	740536	MICRO COMPUTADOR - LOGIN	SL. DE GESSO
105	740537	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	SL. DE GESSO
106	740538	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	SL. DE GESSO
107	740539	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CORREDOR PORTARIA	RECEPCAO
108	740540	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO CORREDOR PORTARIA	RECEPCAO
109	740541	PURIFICADOR DE AGUA	RECEPCAO
110	740543	MICRO COMPUTADOR - NEWDRIVE	RECEPCAO
111	740544	MICRO COMPUTADOR - DELL	RECEPCAO
112	740545	TELEVISOR 32 - SONY	RECEPCAO
113	740546	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COM 02 PORTAS NA COR MARRO	PRESTACAO DE CONTAS
114	740547	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	PRESTACAO DE CONTAS
115	740548	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COM 02 PORTAS CONFECCIONADO	OBS. PEDIATRICA
116	740549	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	OBS. PEDIATRICA
117	740550	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	OBS. PEDIATRICA
118	740551	MICRO COMPUTADOR - KELOW	OBS. PEDIATRICA
119	740552	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	OBS. ADULTO
120	740553	MICRO COMPUTADOR - LOGIN	OBS. ADULTO
121	740554	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS EM MADEIRA BRANCA COM RODINHAS	GERENCIA DE ENFERMAGEM
122	740555	CADEIRA FIXA EM TECIDO	GERENCIA DE ENFERMAGEM
123	740556	CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO	GERENCIA DE ENFERMAGEM
124	740557	CADEIRA GIRATORIA COM BRACO EM COURVIM	GERENCIA DE ENFERMAGEM
125	740558	MICRO COMPUTADOR - DELL	GERENCIA DE ENFERMAGEM
126	740559	MICRO COMPUTADOR - LENOVO	GERENCIA DE ENFERMAGEM
127	740560	ARMARIO BAIXO COM 02 PORTAS NA COR BRANCA	SERVICO SOCIAL
128	740561	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA	SERVICO SOCIAL
129	740562	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO EM COURVIM	SERVICO SOCIAL
130	740563	MICRO COMPUTADOR - NEWDRIVE	SERVICO SOCIAL
131	740564	MESA PARA ESCRITORIO COM 02 GAVETAS CEREJEIRA	DIRECAO
132	740565	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	DIRECAO
133	740566	CADEIRA FIXA SEM BRACO EM TECIDO	DIRECAO

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Tecnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESMA
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Spurris Faim

lois m

134	740567	MICRO COMPUTADOR - NEWDRIVE	ENFERMEIRO LIDER
135	740568	MICRO COMPUTADOR - NEWDRIVE	ENFERMEIRO LIDER
136	740569	CADEIRA GIRATORIA EM POLIPROPILENO	ENFERMEIRO LIDER
137	740570	MICRO COMPUTADOR - LOGIN	ENFERMEIRO LIDER
138	740571	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	RAIO X
139	740572	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COM 02 PORTAS - PANDIN	ROUPA SUJA
140	740573	BALANÇA DIGITAL RAMUSA	ROUPA SUJA
141	740574	ESTANTE EM ACO	NUCLEO DE MANUTENCAO
142	740575	ARMARIO ALTO EM ACO C/ 02 PORTAS	NUCLEO DE MANUTENCAO
143	740576	MICRO COMPUTADOR - NEWDRIVE	NUCLEO DE MANUTENCAO
144	740577	ESTANTE EM ACO	MANUTENCAO
145	740578	ESTANTE EM ACO	MANUTENCAO
146	740579	ARMARIO ALTO EM MADEIRA COM 02 PORTAS CONFECCIONADO NA COR BRANCA	OBS. ADULTO
147	740580	MICRO COMPUTADOR - LENOVO	OBS. ADULTO
148	740581	MESA PARA ESCRITORIO EM MADEIRA MARROM COM 02 GAVETAS	GERENCIA DE ENFERMAGEM

Ronilton Franklin C. Barros
Cdd. 19.535.568-7
Tecnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SCSA
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Luís Raimundo

Luís Raimundo

ANEXO III

RELAÇÃO DOS BENS DE TERCEIROS

São bens patrimoniais que se encontram no **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, locados pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS, para as atividades da Unidade.


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SRS
Mat. 19.318.338-5


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932


Gustavo Reim


Laís

RELAÇÃO DOS BENS EM TERCEIRO

Itens	Descrição	Setor
1	BALCAO TERMICO	REFEITORIO
2	CARRO PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS	COPA
3	CONDICIONADOR DE AR - SPRINGER	LASSIFICACAO DE RISCO 2
4	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 9.000 CONFEE	PRESTACAO DE CONTAS
5	CONDICIONADOR DE AR SPLIT - 9.000 MIDEIA	OBS. ADULTO ISOL. MASC.
6	CONDICIONADOR DE AR SPLIT SPRINGER	CONFORTO 3
7	CORTINA DE AR	RECEPCAO
8	CORTINA DE AR	SL. DE MEDICACAO
9	CORTINA DE AR	NEBOLIZACAO
10	CR DIGITAL DE IMAGEM - FUGIFILM	RAIO X
11	ECG MICROMED + NOTEBOOK LENOVO	SL. VERMELHA
12	FOGAO DOMESTICO	COPA
13	FORNO MICROONDAS - MIDEIA	REFEITORIO
14	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	CORREDOR DE SUPRIMENTO
15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	DEP. PESSOAL
16	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	OBS. ADULTO
17	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	CONSULTORIO 6
18	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	ADMINISTRATIVO
19	MESA DE REFEITORIO FIXA C/ 04 ACENTO	REFEITORIO
20	MESA DE REFEITORIO FIXA C/ 04 ACENTO	REFEITORIO
21	MESA DE REFEITORIO FIXA C/ 04 ACENTO	REFEITORIO
22	MESA DE REFEITORIO FIXA C/ 04 ACENTO	AREA EXTERNA
23	MICRO COMPUTADOR	LABORATORIO
24	REFRIGERADOR RESIDENCIAL - CONSUL	COPA

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SCSAD
Mat. 19.318.238-5

Rodrigo S.
Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Guilherme Faim

João Ang

ANEXO IV

RELATÓRIO DE TRANSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Relatório realizado pela empresa **FRACTAL ENGENHARIA** na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, no período da transição solicitado pelo Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS, informandos os equipamentos em uso, parados e as justificativas no relatório anexo.


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SIO
Mat. 19.218.338-1


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932


Paulo Paim


João Np

RELATÓRIO DE DESMOBILIZAÇÃO

ENGENHARIA CLÍNICA

Unidade de Pronto Atendimento – Feira de Santana

FRACTAL ENGENHARIA HOSPITALAR

NOVEMBRO, 2024

Sumário

1. GENERALIDADES	3
2. EQUIPE RESPONSÁVEL	4
3. DESTINATÁRIOS	5
4. CONSIDERAÇÕES GERAIS	6
5. EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES	7
6. HISTÓRICO DA ENGENHARIA CLÍNICA	42
7-. CONCLUSÃO	43
8. RESPONSÁVEL TÉCNICO	176
9. ANEXOS	177
ANEXO I – HISTÓRICO DOS EQUIPAMENTOS.....	178
ANEXO II – EQUIPAMENTOS INDISPONÍVEIS.....	179
ANEXO III – ORDEM DE SERVIÇO	180

1. GENERALIDADES

1.1 Objetivo

O principal objetivo deste relatório de desmobilização de engenharia clínica é estabelecer o estado em que se encontram os equipamentos que foram gerenciados pela Fractal Engenharia no período vigente do contrato nº 592/ 2023 na Upa de Feira de Santana, na gestão da OS. Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde.

Sendo assim, ao findarmos o contrato com a OS, elaboramos um relatório ao qual é possível observar a real situação dos equipamentos hoje alocados no estabelecimento assistencial de saúde – EAS, compreender quais estão em uso, quais estão parados e as justificativas, fotos atuais e seus dados.

2. EQUIPE RESPONSÁVEL

A elaboração do relatório de desmobilização foi realizada pela empresa de Fractal Engenharia Hospitalar o qual atua sobre a engenharia clínica, sendo estes profissionais:

Diretor – Julian Lavin Esteban Gutierrez - CREA: 39925-BA

Gerente de Engenharia Hospitalar – Lidiany Leite – CREA: 1017241937-GO

Coordenadora de Unidade – Debora Rocha

Técnico – Jonnhe Valdir Dantas

3. DESTINATÁRIOS

Este relatório é destinado aos órgãos fiscais responsáveis e a contratante. Este relatório contempla a descrição dos equipamentos médico-hospitalares disponibilizados na unidade de saúde, assim como suas situações atuais.

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS


A Engenharia Clínica tem como meta primordial otimizar a utilização da tecnologia médica, visando proporcionar aos usuários e às equipes assistenciais elevada qualidade e segurança, ao mesmo tempo em que busca minimizar custos. Nesse contexto, é incumbência do setor de Engenharia Clínica aderir estritamente aos critérios estabelecidos por normas e regulamentos institucionais vigentes, bem como aplicar conhecimentos especializados na gestão abrangente de toda e qualquer tecnologia médico-hospitalar. Essa abordagem visa assegurar o funcionamento ininterrupto da unidade EAS, livre de quaisquer entraves.

5. EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES


ADM DE ENFERMAGEM



Equipamento: OTOSCÓPIO
Fabricante: MD
Modelo: DT 801
N° de Série:
Patrimônio:
Acessórios: Base e Cabo
Descrição: Equipamento em perfeito estado

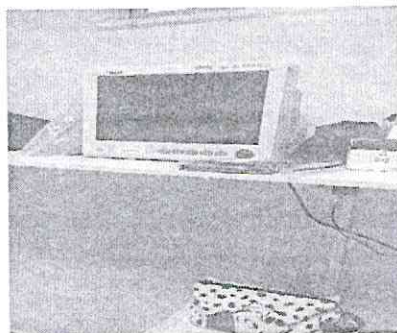


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série: V600100258
Patrimônio: 00340234
Acessórios: equipamento sem sensor de oximetria, sem cabo ECG, sem cabo extensor de manguito sem cabo de força. Possui capnografo
Descrição: Equipamento em perfeito estado

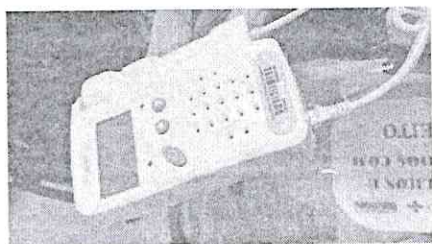


Equipamento: Detector Fetal
Fabricante: MD
Modelo: FD- 200D
N° de Série:
Patrimônio: 00666188
Acessórios: equipamento completo com transdutor e cabo.
Descrição: Equipamento em perfeito estado




Equipamento: Venoscópio
Fabricante: DUAN
Modelo: VENOSBABY
Nº de Série: 01072323
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

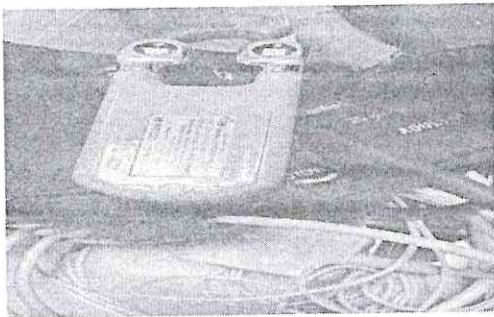

Equipamento: Venoscópio
Fabricante: DUAN
Modelo: VENOSBABY
Nº de Série: 01072033
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado

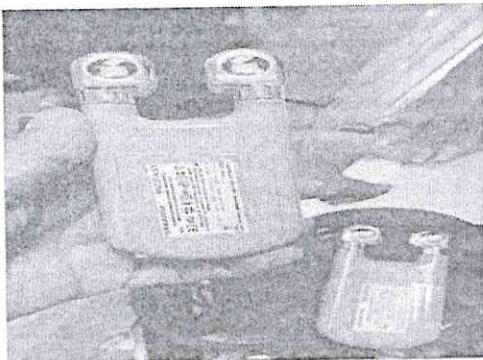


Equipamento: Venoscópio
Fabricante: DUAN
Modelo: VENOSBABY
Nº de Série: 01072356
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado

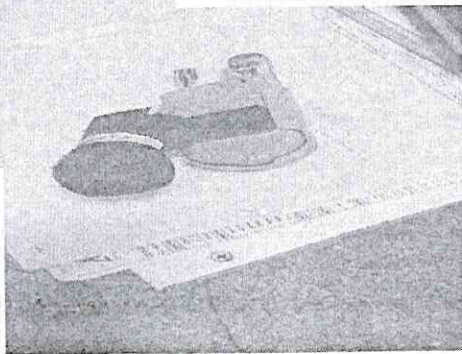


Equipamento: Venoscópio
Fabricante: DUAN
Modelo: VENOSBABY
N° de Série:
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento precisa de reparo.


CLASSIFICAÇÃO DE RISCO I

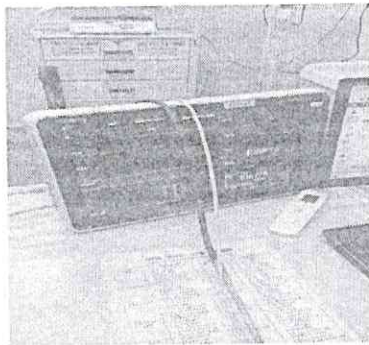


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: MINDRAY
Modelo: UMEC 15
N° de Série: KR- 9900
Patrimônio: 006639241862
Acessórios: equipamento possui sensor de oximetria, sem cabo ECG, possui cabo extensor de manguito e com cabo de força. Possui capnógrafo.
Descrição: Equipamento em funcionamento

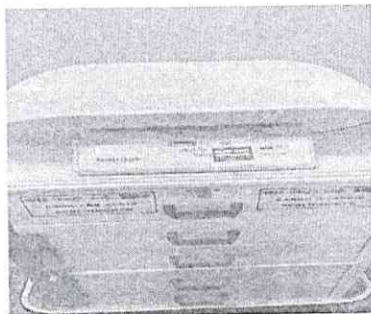


Equipamento: Balança Eletrônica
 Pediátrica
Fabricante: BALMAK
Modelo: ELP-25BB
N° de Série: 029075
Patrimônio: 002212
Acessórios: cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

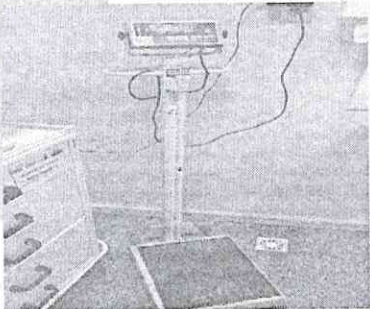	Equipamento: Balança Eletrônica Fabricante: LIDER Modelo: P- 300 C Nº de Série: 35366 Patrimônio: 00333710: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--

CLASSIFICAÇÃO DE RISCO II

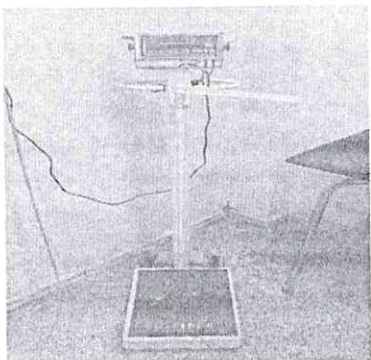	Equipamento: Balança Eletrônica Fabricante: LIDER Modelo: : P- 300 C Nº de Série: 35367 Patrimônio: 00333711 Descrição: : Equipamento em perfeito estado. .
--	---

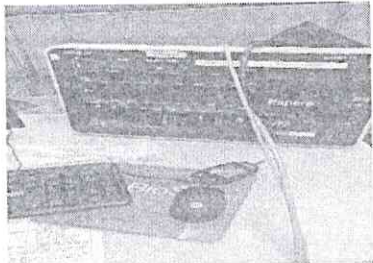
	Equipamento: Monitor Multiparâmetro Fabricante: MINDRAY Modelo: UMEC 15 Nº de Série: KR-99001868 Patrimônio: Acessórios: Sensor de oximetria, cabo extensor de manguito, manguito, cabo de força e capnografo. Não possui sensor de temperatura. Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	---



Equipamento: Eletrocardiógrafo
Fabricante: MICROMED
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

Equipamento Locado (ADS
 TELEMEDICINA)

CENTRAL DE MATERIAL ESTERILIZADO

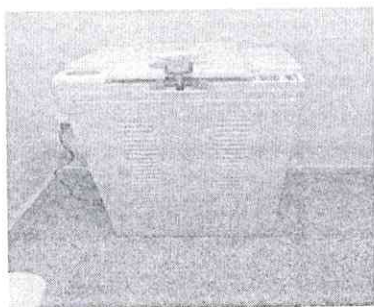



Equipamento: Autoclave
Fabricante: STREMAX
Modelo: Digital Flex
N° de Série: ST0051689
Patrimônio: 00635400
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.





Equipamento: Seladora
Fabricante: SELAPACK
Modelo: SM350PLUS
N° de Série: 19004000789/2017
Patrimônio: 00370493
Acessórios: .
Descrição: Equipamento em perfeito estado


CONSULTÓRIOS 01,02,03,04,5,06

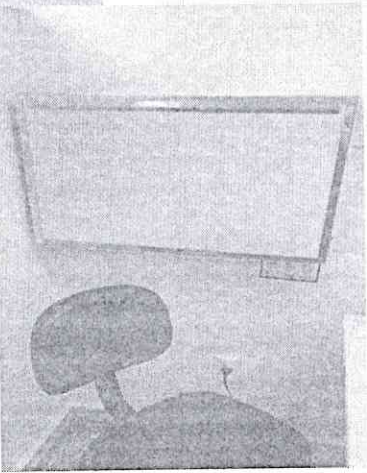
	Equipamento: Negatoscópio Fabricante: TECMED Modelo: N° de Série: Patrimônio: 00393196 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado CONSULTÓRIO 01
---	--

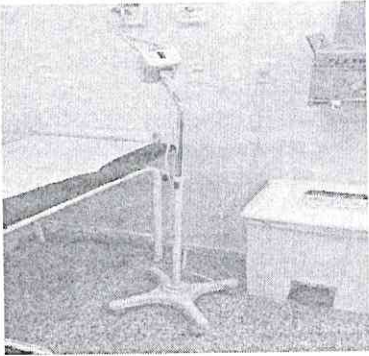
	Equipamento: Foco Portátil Fabricante: MEDPEJ Modelo: FL-4000HREL N° de Série: 168014 Patrimônio: 00416759 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado CONSULTÓRIO 01
---	--

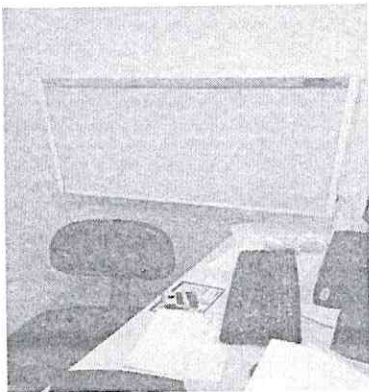	Equipamento: Negatoscópio Fabricante: LEVITA Modelo: N° de Série: Patrimônio: Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado CONSULTÓRIO 02
---	---

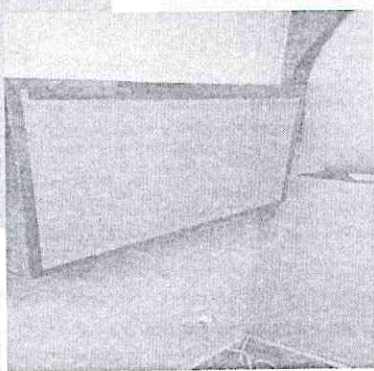	Equipamento: Negatoscópio Fabricante: Modelo: Nº de Série: Patrimônio: 00396293 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado CONSULTÓRIO 03
---	---

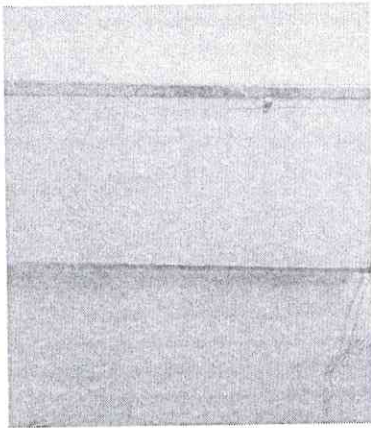
	Equipamento: Negatoscópio Fabricante: Modelo: Nº de Série: Patrimônio: 00396601 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado CONSULTÓRIO 04
--	---

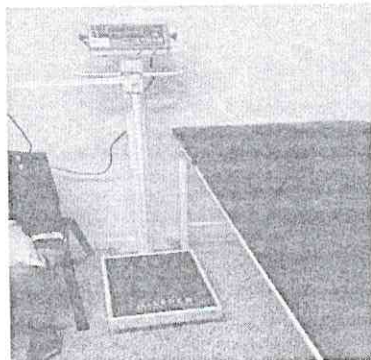	Equipamento: Balança Eletrônica Fabricante: LIDER Modelo: P 300- C Nº de Série: 35368 Patrimônio: 00396601 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado CONSULTÓRIO 04
---	--

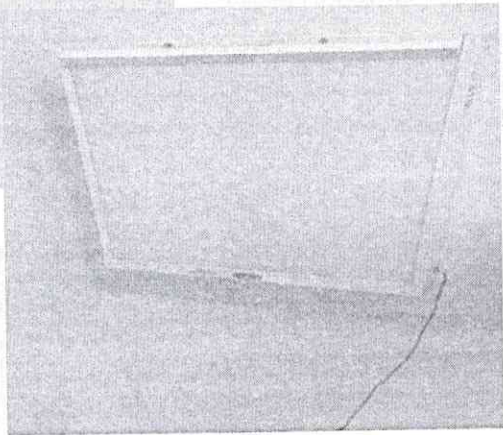

Equipamento: Negatoscópio
Fabricante:
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio: 00396601
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado

CONSULTÓRIO 05

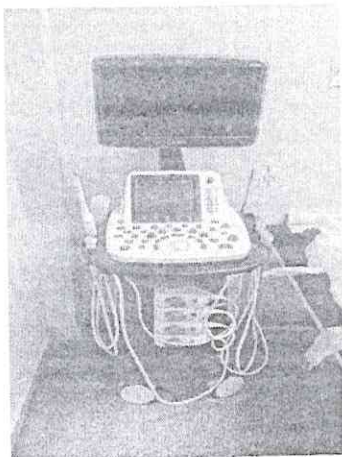

Equipamento: Ultrassom
Fabricante: SAEVO
Modelo: FTFT22
N° de Série:
Patrimônio: 00530359
Acessórios: Transdutores, Cabo de força
Descrição: Equipamento em perfeito estado

CONSULTÓRIO 06

CURATIVO


	Equipamento: Cardioversor Fabricante: CMOS DRAKE Modelo: VIVO Nº de Série: 321080459 Patrimônio: 00510325 Acessórios: Pás Externas intercambiáveis (Adulto/Infantil), Cabo de força e gel Descrição: Equipamento em perfeito estado
---	---

ESTOQUE DO LABORATÓRIO

	Equipamento: Microscópio Fabricante: BIOFOCUS Modelo: Nº de Série: Patrimônio: 002495 Acessórios: Cabo de alimentação. Descrição: Equipamento funciona, porém, é backup
--	---


	Equipamento: Microscópio Fabricante: EUROFARMA Modelo: Nº de Série: Patrimônio: 377295 Acessórios: Cabo de alimentação. Descrição: Equipamento funciona, porém, é backup.
---	---

ISOLAMENTO MASC/FEMININO

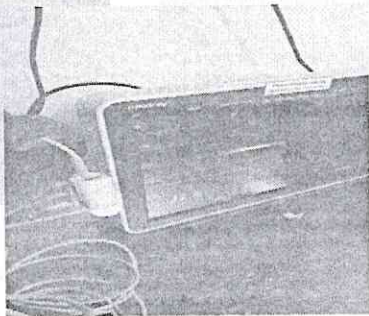

Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: MINDRAY
Modelo: UMEC 15
Nº de Série: KR-99001860
Patrimônio:
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, cabo extensor de manguito, manguito e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado o mesmo está em uso.


ISOLAMENTO FEMININO

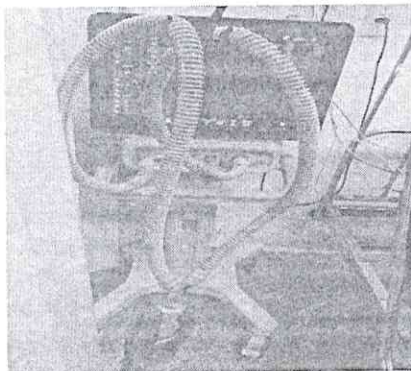

Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: LEISTUNG
Modelo: LUFT 5
Nº de Série:
Patrimônio: 00504865
Acessórios: Circuito, mangueiras, : Válvula exalatória, braço articulado e cabo de força.

Descrição: : Equipamento em perfeito estado o mesmo está em uso.


ISOLAMENTO MASCULINO

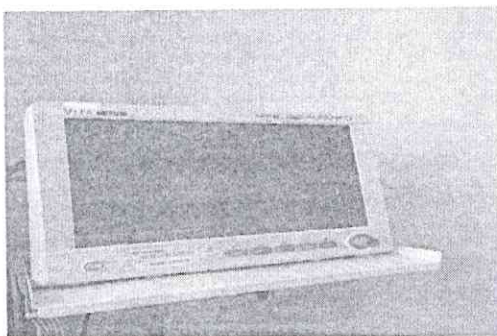


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: Vita 600
Nº de Série: V600100278
Patrimônio: 00340237
Acessórios: Sensor oximetria e cabo de força, cabo ECG, manguito.
Descrição: Equipamento em perfeito estado em uso.

ISOLAMENTO MASCULINO

LABORATÓRIO

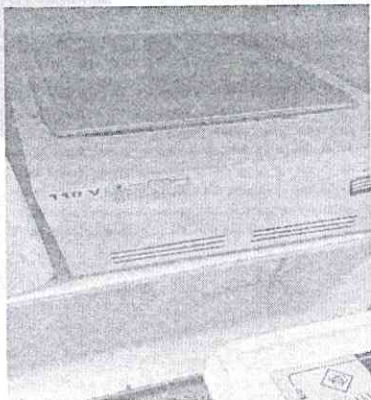


Equipamento: Banho Maria
Fabricante: NOVA
Modelo: NF1229
N° de Série:
Patrimônio: 00368785
Acessórios: .
Descrição: Equipamento em perfeito estado

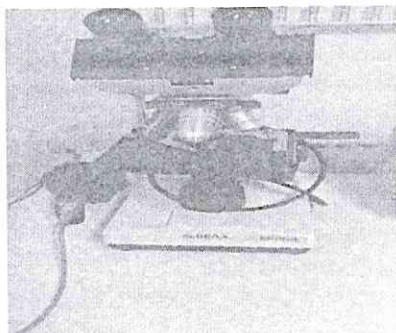


Equipamento: Microscópio
Fabricante: BRAX
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio: 00339499
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Centrífuga
Fabricante: CENTRILAB
Modelo: 80-2B-15ML
N° de Série: 76477
Patrimônio: 002304
Acessórios: Fonte de alimentação
Descrição: Equipamento em perfeito parou de funcionar ,já estamos com orçamento para conserto externo.

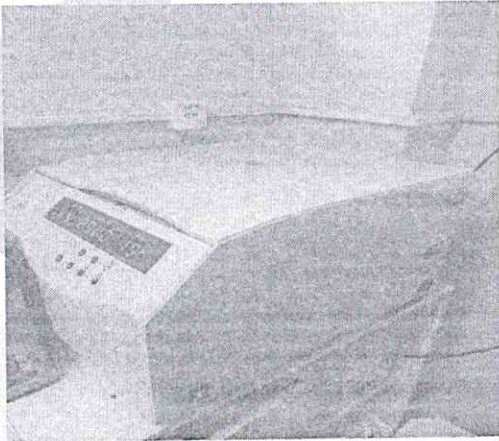


Equipamento: Centrífuga
Fabricante: DAIKI
Modelo: DT- 400
N° de Série:
Patrimônio: 00414625
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

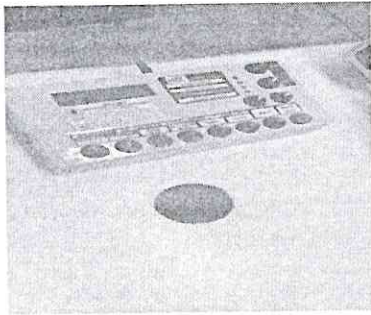


Equipamento: Contador Manual de Célula
Fabricante: KACIL
Modelo: HM 01
N° de Série:
Patrimônio: 002344
Acessórios: fonte de alimentação.
Descrição: Equipamento em perfeito estado

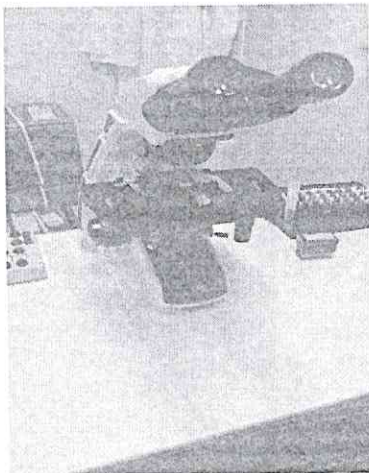


Equipamento: Microscópio
Fabricante: GLOBAL OPTICS
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio: 002494
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

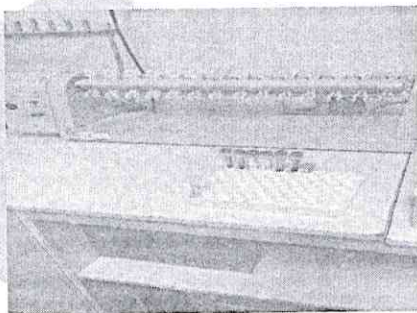

Equipamento: Homogenizador de Sangue
Fabricante: KACIL
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio: 002346
Acessórios: cabo de alimentação.
Descrição: Equipamento em perfeito estado

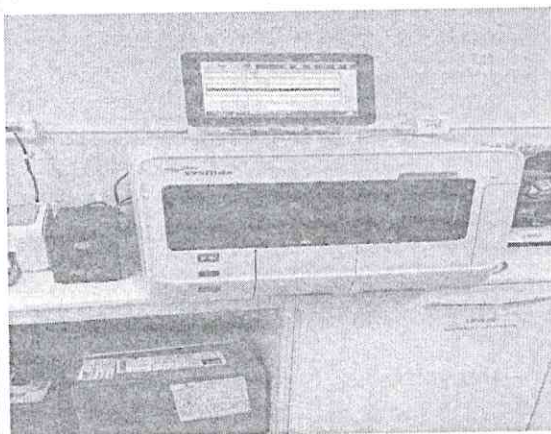

Equipamento: Aparelho de Hematologia
Fabricante: SYSMEX
Modelo: XN - 550
N° de Série: 25521
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.
 Equipamento locado pela empresa Biosystem

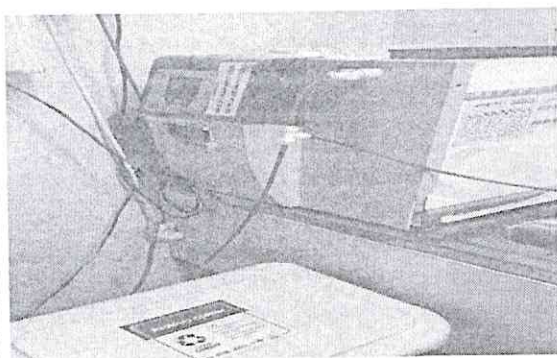

Equipamento: Deionizador
Fabricante:
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.
 Equipamento locado pela empresa Biosystem

	Equipamento: Aparelho de Hematologia Fabricante: SYSMEX Modelo: XN-550 N° de Série: C5190 Patrimônio: Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado. Equipamento locado pela empresa Biosystem
---	---

MANUTENÇÃO


	Equipamento: Eletrocardiógrafo Fabricante: BIONET Modelo: CARDIO CARE Descrição: Equipamento funcionando, porém, não possui o cabo Ecg.
--	---

MEDICAÇÃO


	Equipamento: Bomba de Infusão Fabricante: SAMTRONIC 550T2 Modelo: ST1000 Descrição: Equipamento funcionando e em uso Equipamento Locado pela empresa Infusomed
---	---

	Equipamento: Oxímetro para Dedo Fabricante: SWISSCARE Modelo: Nº de Série: Patrimônio: Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	---

NEBULIZAÇÃO

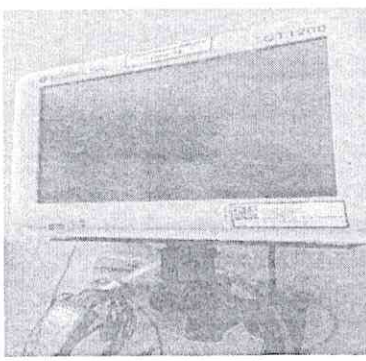	Equipamento: Monitor Multiparâmetro Fabricante: GLOBALTEC Modelo: GT 1200 Nº de Série: Q068E066505 Patrimônio: 504527 Acessórios: Sensor de oximetria, manguito, cabo de força e cabo ECG Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--


OBSERVAÇÃO ADULTO

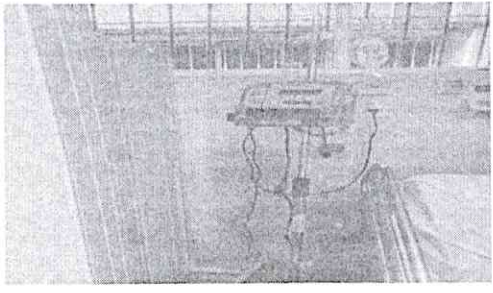	Equipamento: Bomba de Infusão Fabricante: SAMTRONIC 550T2 Modelo: ST1000 Descrição: Equipamento funcionando e em uso Equipamento Locado pela empresa Infusomed
---	---


--	--



Equipamento: Cardioversor
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: VIVO
Nº de Série: 321080441
Patrimônio: 00510326
Acessórios: Pás Externas intercambiáveis (Adulto/Infantil), Cabo de força e gel
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

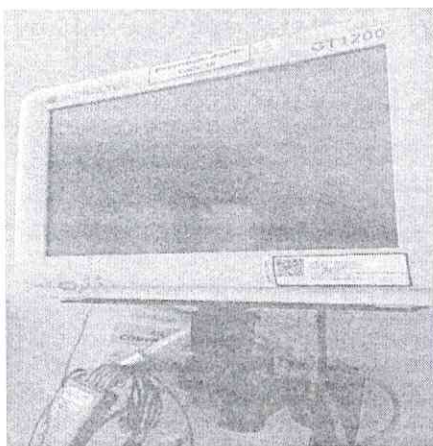

Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: GLOBALTEC
Modelo: GT 1200
Nº de Série:
Patrimônio: 00504531
Acessórios: Sensor de oximetria, manguito, cabo de força e cabo ECG
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

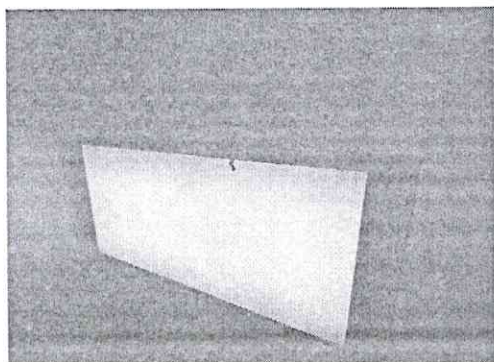

Equipamento: Negatoscópio
Fabricante: TECMED
Modelo:
Nº de Série:
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

OBSERVAÇÃO PEDIATRICA



Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: LEISTUNG
Modelo: PR-5
N° de Série:
Patrimônio: 00633802
Acessórios: circuito, mangueira, cabo de força, válvula, sensor proximal
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Bomba de Infusão
Fabricante: SAMTRONIC 550T2
Modelo: ST1000
Descrição: Equipamento funcionando e em uso
 Equipamento Locado pela empresa Infusomed.


Equipamento: Oxímetro para Dedo
Fabricante: SWISSCARE
Modelo: P-09
N° de Série:
Patrimônio: 00496801
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

	
---	--

	Equipamento: Monitor Multiparâmetro Fabricante: GLOBALTEC Modelo: GT 1200 Nº de Série: Patrimônio: 00504526 Acessórios: braçadeira, cabo ECG, cabo de força Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--


	Equipamento: Cardioversor Fabricante: CMOS DRAKE Modelo: VIVO Nº de Série: 321080456 Patrimônio: 510316 Acessórios: Pás Externas intercambiáveis (Adulto/Infantil), Cabo de força e gel Descrição: Equipamento em perfeito estado
---	---

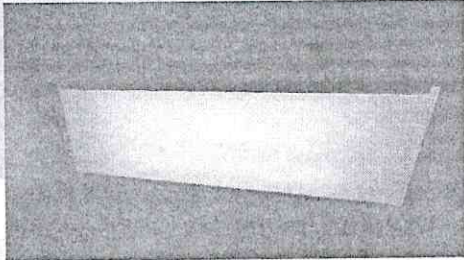	Equipamento: Negatoscópio Fabricante: SANTA LUZIA Modelo: Nº de Série: Patrimônio: 470592 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado..
---	---

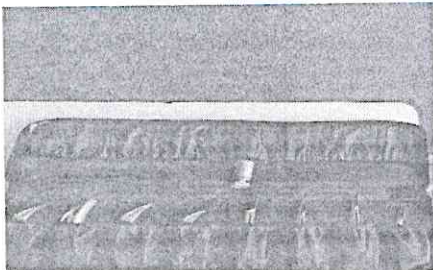	Equipamento: LARINGOSCÓPIO Fabricante: Modelo: Série: Patrimônio: 00663924 Acessórios: 04 LÂMINAS CURVAS E 04 LÂMINAS RETAS Descrição: Equipamento em perfeito estado.
--	--


PESAGEM ROUPA SUJA

	Equipamento: Balança Eletrônica Fabricante: RAMUZA Modelo: DP -300 Série: 35569 Patrimônio: Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
--	--

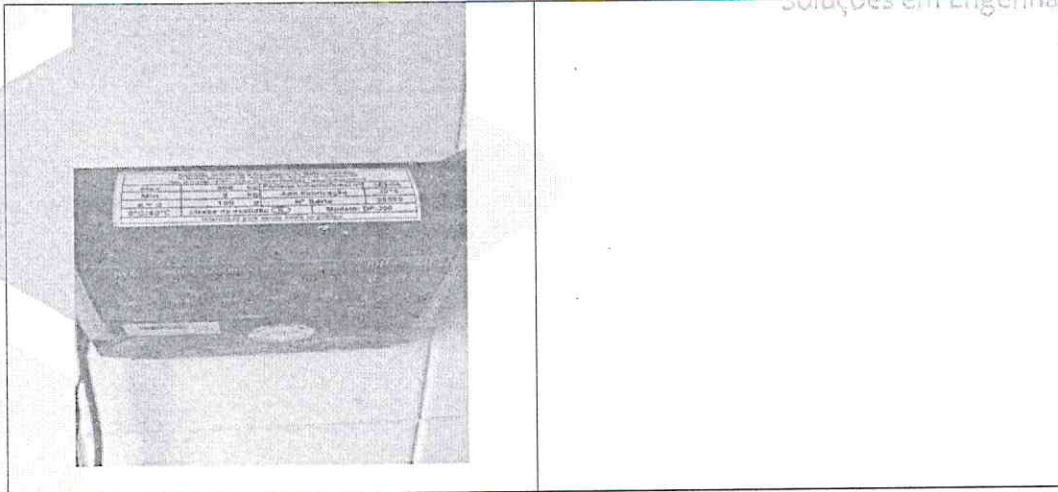


RADIOLOGIA




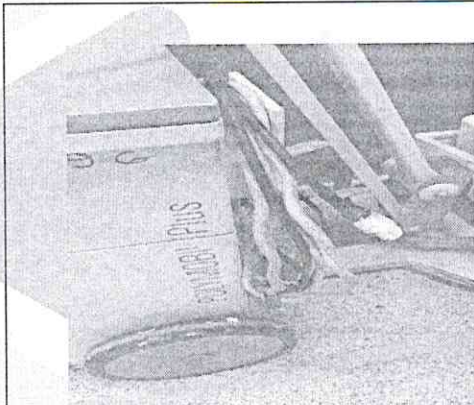

Equipamento: Aparelho de Raio – X Portátil
Fabricante: SIEMENS
Modelo: 10187800
Nº de Série: 20797
Patrimônio: 00274796
Descrição: Equipamento em funcionamento porém disparador não está funcionando corretamente, além do cabo e rodízios encontrarem-se desgastados.

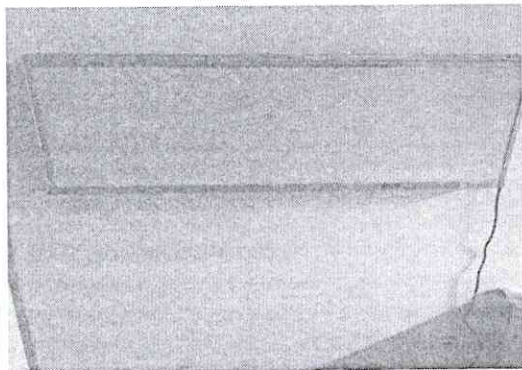


Equipamento: Negatoscópio
Fabricante:
Modelo:
Nº de Série:
Patrimônio:
Descrição: Equipamento em perfeito estado

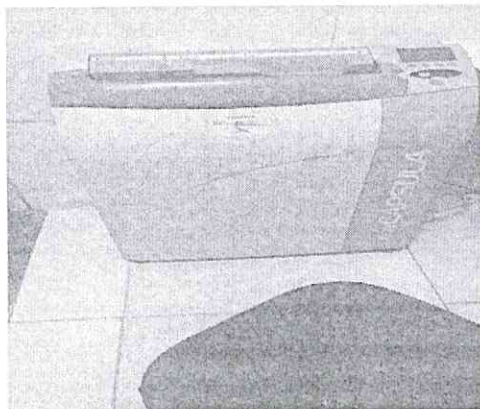



Equipamento: Digitalizadora Radiográfica CR
Fabricante: FUJIFILM
Modelo: FCR CAPSULA XL 2
Nº de Série:
Patrimônio:
Descrição: Equipamento em perfeito estado
 Locada pela empresa Barral

	Equipamento: Impressora Radiográfica Fabricante: Modelo: N° de Série: Patrimônio: 000081 Descrição: Equipamento em perfeito estado Locada pela empresa Barral
---	--


SALA COORDENAÇÃO DE ENFERMAGEM

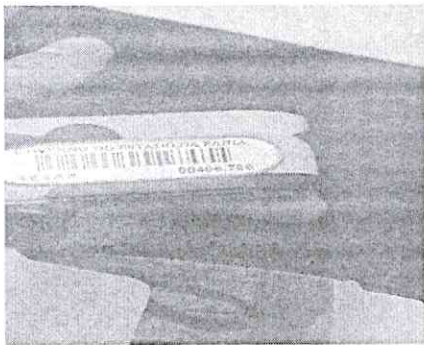	Equipamento: Oxímetro para Dedo Fabricante: SWISSCARE Modelo: N° de Série: Patrimônio: 00496796 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--

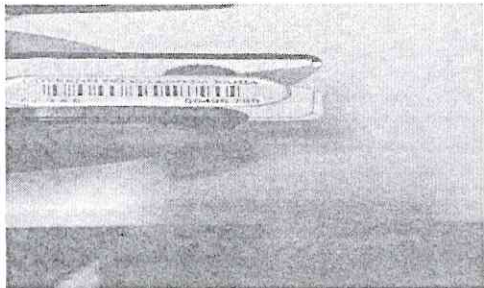	Equipamento: Oxímetro para Dedo Fabricante: SWISSCARE Modelo: N° de Série: Patrimônio: 496790 Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--

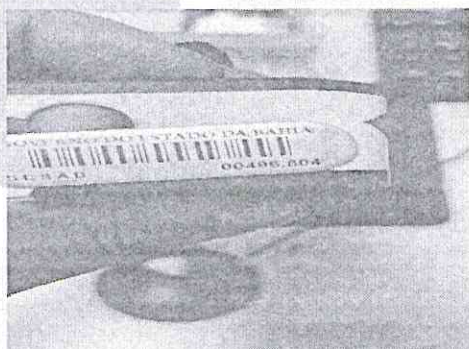


Equipamento: Oxímetro para Dedo
Fabricante: SWISSCARE
Modelo:
Nº de Série:
Patrimônio: 00496804
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado

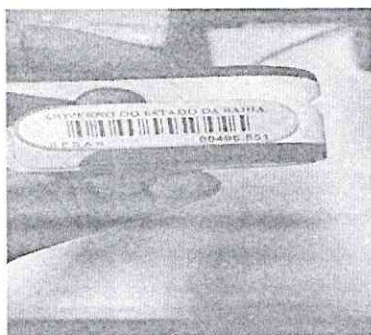


Equipamento: Oxímetro para Dedo
Fabricante: SWISSCARE
Modelo:
Nº de Série:
Patrimônio: 00496851
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Oxímetro para Dedo
Fabricante: SWISSCARE
Modelo:
Nº de Série:
Patrimônio: 00496791
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

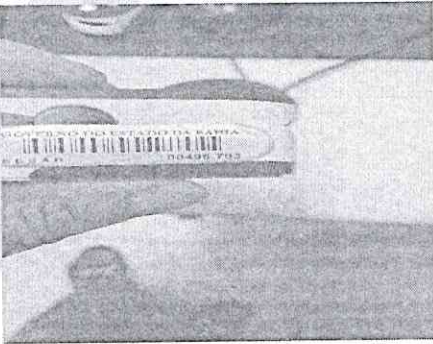	Equipamento: Oxímetro para Dedo Fabricante: SWISSCARE Modelo: N° de Série: Patrimônio: 00496793 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--

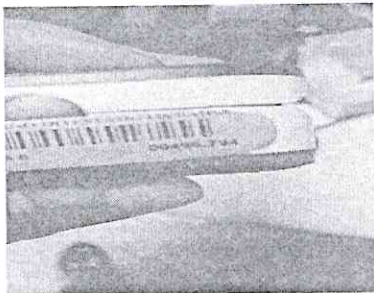
	Equipamento: Oxímetro para Dedo Fabricante: SWISSCARE Modelo: N° de Série: Patrimônio: 00496794 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
--	--

	Equipamento: Oxímetro para Dedo Fabricante: SWISSCARE Modelo: N° de Série: Patrimônio: 00496789 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	--

SALA DE GESSO

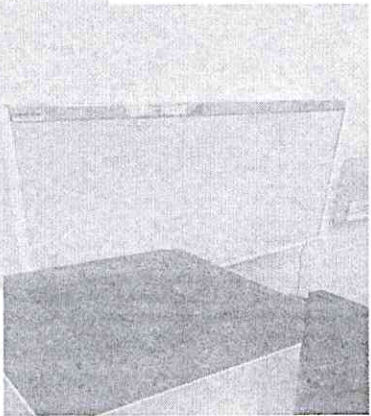	Equipamento: Negatoscópio Fabricante: Móveis Andrade Modelo: N° de Série: Patrimônio: 297518 Acessórios: Descrição: Equipamento em perfeito estado.
---	---


SALA VERMELHA

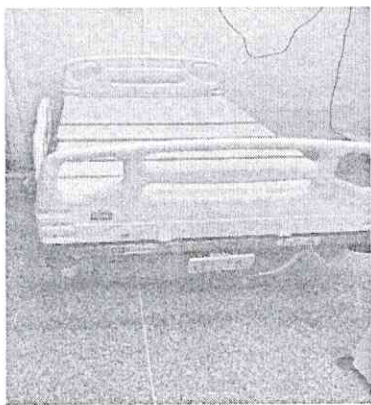	Equipamento: Cama Elétrica Fabricante: Móveis Andrade Modelo: MA-489B200 N° de Série: 14104 Patrimônio: 00709533 Acessórios: Controle Descrição: Cama em perfeito estado.
--	---


	Equipamento: Cama Elétrica Fabricante: Móveis Andrade Modelo: MA-489B200 N° de Série: 13973 Patrimônio: 00709402 Acessórios: Controle Descrição: Cama em perfeito estado, não foi possível tirar foto devido estar ocupada por paciente.
---	--



Equipamento: Cama Elétrica
Fabricante: Móveis Andrade
Modelo: MA-489B200
N° de Série: 13918
Patrimônio: 00708477
Acessórios: Controle
Descrição: Cama em perfeito estado.

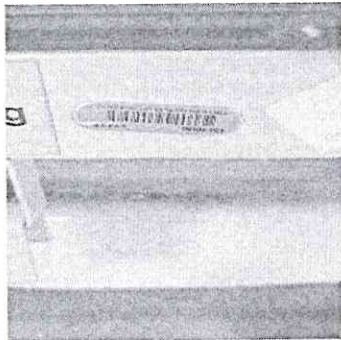


Equipamento: Cama Elétrica
Fabricante: Móveis Andrade
Modelo: MA-489B200
N° de Série: 13912
Patrimônio: 00708459
Acessórios: Controle
Descrição: Cama esta com a parte mecânica danificada porém em garantia empresa já foi acionada para reparo ,não foi possível tirar foto devido estar ocupada por paciente.

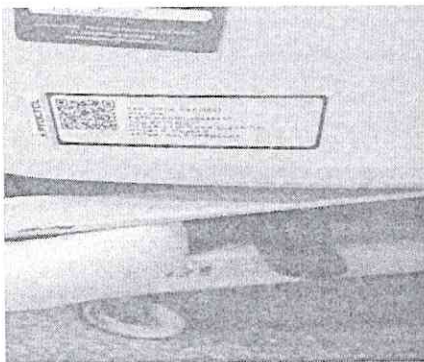

Equipamento: Cama Elétrica
Fabricante: RC MOVEIS
Modelo: RC203-E
N° de Série:
Patrimônio: 00538438
Acessórios: Controle
Descrição: Cama em perfeito estado, não foi possível tirar foto devido estar ocupada por paciente.




Equipamento: Cama Elétrica
Fabricante: RC MOVEIS
Modelo: RC203-E
N° de Série:
Patrimônio: 538437
Acessórios: Controle
Descrição: Cama em perfeito estado, não foi possível tirar foto devido estar ocupada por paciente.

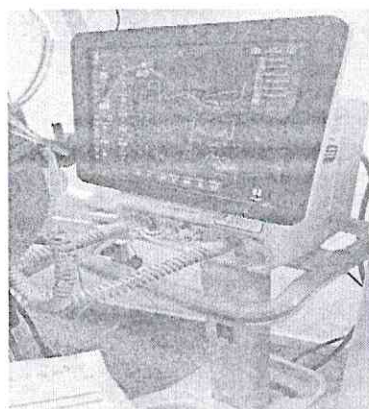

Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: LEISTUNG
Modelo: LUFT5
N° de Série: E21215
Patrimônio: 00504851
Acessórios: Válvula exalatória, braço articulado, circuito e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: MAQUET
Modelo: SERVOS S
N° de Série: 14123
Patrimônio: 00252481
Acessórios: mangueira, braço articulado e cabo de força, célula de O₂
Descrição: Equipamento em perfeito estado porém precisa substituir bateria.

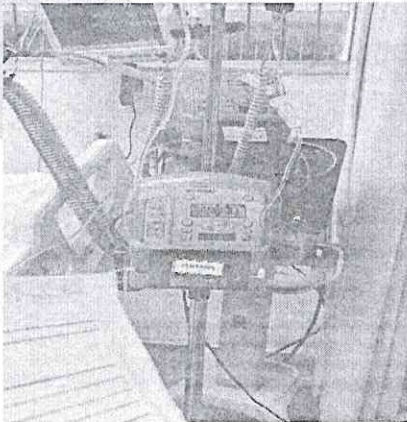

Equipamento: Bomba de Infusão
Fabricante: SAMTRONIC 550T2
Modelo: IST1000
Nº de Série: 59021, 59018, 59007
Patrimônio:
Acessórios: cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

Locado pela empresa Infusomed

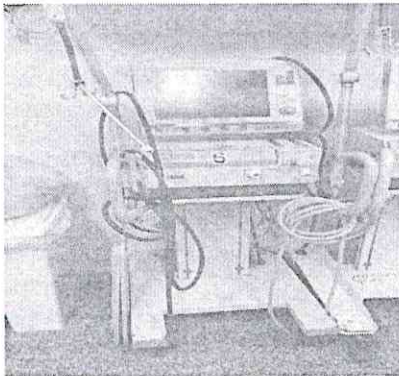


Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: MAQUET
Modelo: SERVOS S
Nº de Série: 14113
Patrimônio: 284042
Acessórios: mangueira, braço articulado e cabo de força, célula de O₂
Descrição: Equipamento em perfeito estado, porém necessário substituir bateria.




Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: LEISTUNG
Modelo: PR4- G TOUCH
Nº de Série: H21024
Patrimônio: 00510285
Acessórios: Válvula exalatória, braço articulado, mangueira, sensor proximal e cabo de força,
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: LEISTUNG
Modelo: PR4- G TOUCH
N° de Série: G21006
Patrimônio: 00507492
Acessórios: Válvula exalatória, braço articulado, mangueira, sensor proximal e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

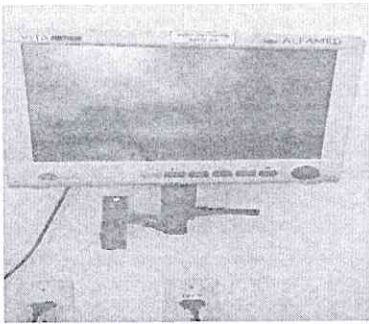


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série: V600001240
Patrimônio: 00413673
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito e cabo de força, sem capnografia..
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

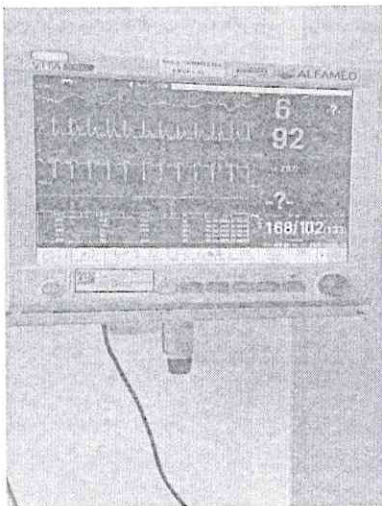


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série: V600100250
Patrimônio: 00340238
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito e cabo de força, sem capnografia..
Descrição: Equipamento em perfeito

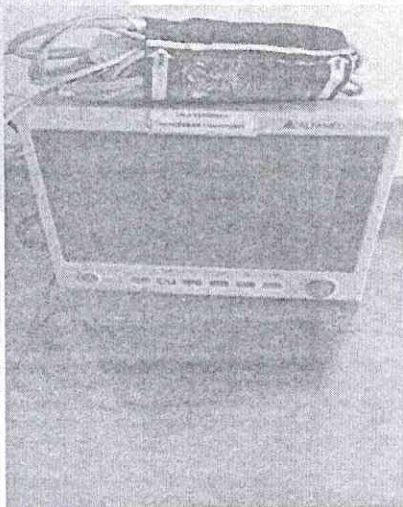


Equipamento: Monitor Multiparâmetro de Transporte
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 500 E
Nº de Série: V5E0000166
Patrimônio: 00404659
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito sem cabo de força e sem capnografia.
Descrição: Equipamento em perfeito

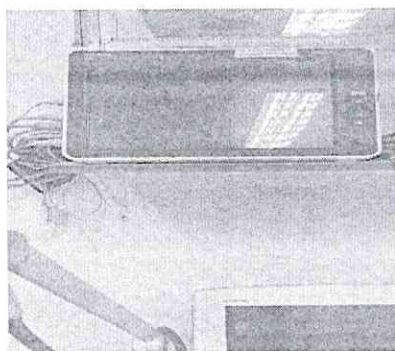


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: MINDRAY
Modelo: UMEC 15
Nº de Série: KR-99001867
Patrimônio:
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito apto para uso porém com arranhões na tela.

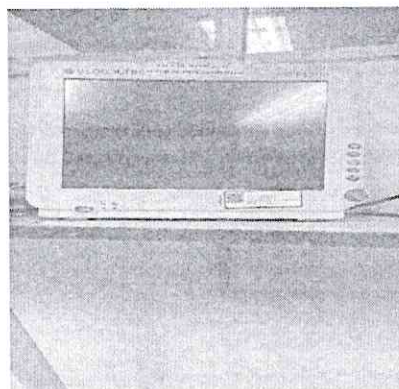


Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: GLOBALTEC
Modelo: GT 1200
Nº de Série: Q068E066405
Patrimônio: 00504530
Acessórios: Possui todos os acessórios com cabo de força, sem capnografia e sem tampa lateral.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

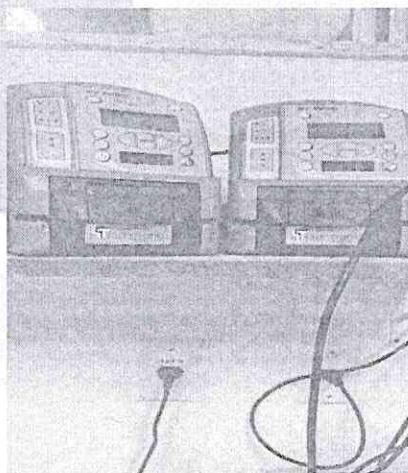


Equipamento: Bomba de Infusão
Fabricante: SAMTRONIC 550T2
Modelo: ST1000
N° de Série: 59027, 59022
Descrição: Equipamento funcionando e em uso
 Equipamento Locado pela empresa Infusomed

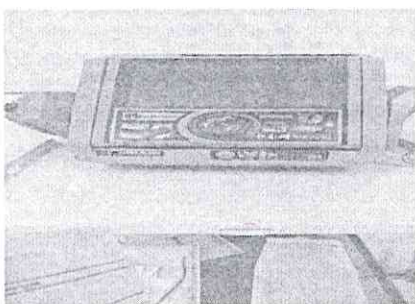

Equipamento: Cardioversor
Fabricante: CMOS DRAKE
Modelo: VIVO
N° de Série: 321080421
Patrimônio: 00510324
Acessórios: Pás Externas intercambiáveis (Adulto/Infantil), Cabo de força e gel..
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

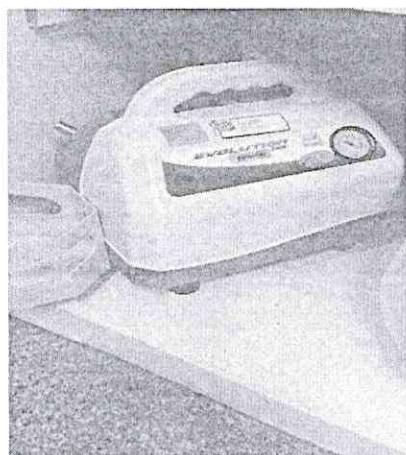

Equipamento: Aspirador Portátil
Fabricante: PROTEC
Modelo: EVOLUTION 5000
N° de Série:
Patrimônio: 00343861
Acessórios: sem frasco.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

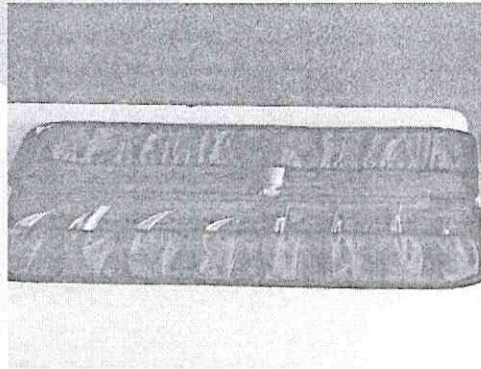


Equipamento: Laringoscópio
Fabricante:
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio: 00663919
Acessórios: 04 Laminas curvas e 04 lâminas retas
Descrição: Equipamento em perfeito estado.



Equipamento: Aspirador Portátil
Fabricante: PROTEC
Modelo: EVOLUTION 5000
N° de Série:
Patrimônio: 00343860
Acessórios: com frasco, filtro bacteriológico. mangueira
Descrição: Equipamento em perfeito estado..




Equipamento: Aspirador Portátil
Fabricante: PROTEC
Modelo: EVOLUTION 5000
N° de Série:
Patrimônio: 00343850
Acessórios: com frasco, filtro bacteriológico. mangueira
Descrição: Equipamento em perfeito estado..

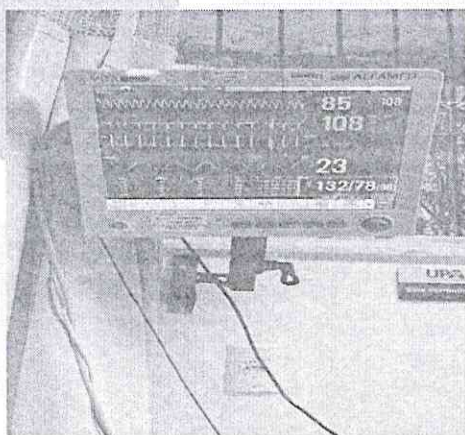

Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série: V600100256
Patrimônio: 00340235
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série:
Patrimônio: 00413672
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito, sem capnografia e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

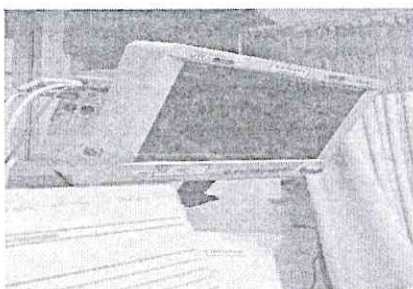

Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série: V600200209
Patrimônio: 00343625
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito, sem capnografia e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.



Equipamento: Negatoscópio
Fabricante:
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio: 00391538
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado

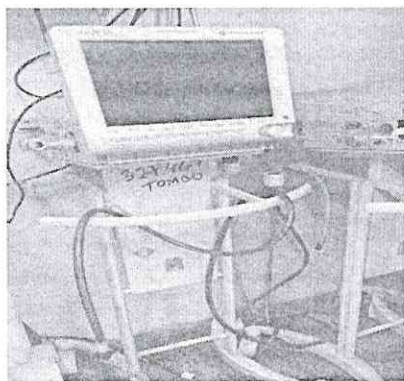

Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: INTERMED
Modelo: IX- 5
N° de Série: IX5-2013-09- 00742
Patrimônio: 00327464
Acessórios: mangueira, sensor proximal, válvula exalatória e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.



Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: INTERMED
Modelo: IX- 5
N° de Série: IX5-2013-09- 00953
Patrimônio: 00324623
Acessórios: mangueira, sensor proximal, válvula exalatória e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.




Equipamento: Ventilador Pulmonar
Fabricante: INTERMED
Modelo: IX- 5
N° de Série: IX5-2013-09- 00741
Patrimônio: 00327467
Acessórios: mangueira, sensor proximal, válvula exalatória e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado.



Equipamento: Eletrocardiógrafo
Fabricante: MICROMED
Modelo:
N° de Série:
Patrimônio:
Acessórios:
Descrição: Equipamento em perfeito estado.

Equipamento Locado (ADS
TELEMEDICINA)

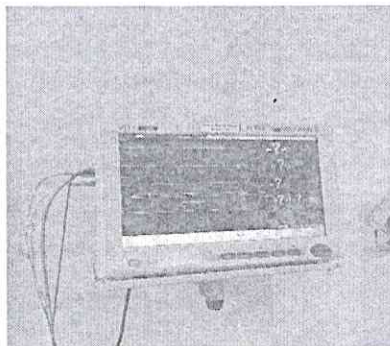

Equipamento: Monitor Multiparâmetro
Fabricante: ALFAMED
Modelo: VITA 600
N° de Série: V600100279
Patrimônio: 00340233
Acessórios: Sensor de oximetria, cabo ECG, manguito e cabo extensor de manguito e cabo de força.
Descrição: Equipamento em perfeito estado

6. HISTÓRICO DA ENGENHARIA CLÍNICA

A Fractal Engenharia assumiu, a engenharia clínica da Upa Feira de Santana no dia 11 de fevereiro de 2019, contrato firmado com a Organização Social Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde (INTS). O contrato abrangeu as atividades de Gestão da Engenharia Clínica da Unidade, onde a equipe técnica responsável geriu e acompanhou os processos de manutenção preventiva, corretiva, calibrações, ensaios de segurança elétrica e qualificações em equipamentos médicos assistenciais. Conforme planejado ao longo desses anos, as manutenções transcorreram de acordo com o cronograma e necessidades, e as certificações correspondentes foram anexadas às ordens de serviço no sistema Effort. Em observância à prática regular, a consolidação de dados no sistema é realizada todo último dia útil de cada mês, possibilitando à engenharia clínica gerar indicadores relativos a manutenções corretivas, programadas e disponibilidade de equipamentos. Essa consolidação inviabiliza a reabertura ou alteração das ordens de serviço do mês anterior, assegurando a integridade dos registros.

Segue anexo todas as ordens de serviço do período para conclusão do processo de desligamento da Fractal Engenharia no contrato firmado junto ao INTS.

7. CONCLUSÃO

Em conclusão, a Fractal Engenharia desempenhou suas atividades no contrato de gestão da engenharia clínica para a Upa Feira de Sanatana com eficiência, destacando-se na execução das manutenções programadas, no atendimento às correções e na prestação de toda a assistência necessária aos equipamentos médico-assistenciais, em conformidade com as legislações aplicáveis, como a RDC 509:2021 e NBR 15.943: 2011.

Como parte do encerramento do contrato, fornecemos este relatório de desmobilização, contendo informações essenciais para orientar e dar continuidade aos serviços pela nova empresa contratada, além de manter um histórico completo de todo o período em que estivemos vinculados ao INTS, em respeito ao compromisso com a integridade dos registros.

Além disto, é importante salientar que dos 104 equipamentos, 25 são equipamentos comodatados pela empresa INFUSOMED (Bombas de Infusão), e 03 equipamento laboratoriais locado pela empresa BIOSYSTEM, 02 ECG locados pela empresa ADS, 01 CR e 01 Impressora do CR locado pela empresa BARRAL.

8. RESPONSÁVEL TÉCNICO



Debora Evani Rocha
Coordenadora de Unidade

Coordenadora de Unidade
Debora Evani Rocha



Lidiany Leite
Engenharia Clínica e Manutenção
CREA 1017241937-GO

Gerente de Engenharia Hospitalar
Lidiany Leite
CREA: 1017241937 – GO



Diretor
JULIAN ESTEBAN LAVIN GUTIERREZ
CREA: 0504976745- SP

ANEXO V

RELAÇÃO DOS BENS EM DESUSO

Trata – se de bens localizados na **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, equipamentos que encontram- se em desuso para análise e distribuição.

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SCS
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Luiz Faria

Luiz Faria

RELAÇÃO DOS BENS EM DESUSO

Itens	Tombo	Descrição	Setor	Dt. Aquisição	Valor Aquisição
70	476646	CONCENTRADOR DE OXIGENIO - DESCRICAO: CONCENTRADOR, de Oxigenio, equipamento estacionario para oxigenoterapia e nebulizacao em um so equipamento. destina-se a fornecer alta concentracao de oxigenio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. pode ser utilizado de modo continuo em domicilio, hospitais, ambulatorios e clinicas. a interface para suporte de oxigenio pode ser por meio de cateter nasal ou mascara - fornece um volume continuo de ar superoxigenado separando o oxigenio contido no ar ambiente. a saida de ar permite que o equipamento entregue tratamentos de nebulizacao com remedios simultaneamente a entrega de oxigenio. Capaz de entregar pelo menos 90% de pureza de oxigenio. Fluxo de pelo menos entre 0 e 5 litros por minuto (lpm) - Voltagem 220 v - modelo : NCM SH: 9019.20.10 CFOP: 6949 NF - 43441 - Fornecedor: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PROC. DE DOAÇÃO SEI : 019.5060.2021.0062167-34 - DOADO PELA OPAS- Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) .	NUCLEO DE MANUTENCAO	24/05/2021	R\$ 6.100,00

Ronilton Franklin C. Barros
Cid. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESMA
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

Quiszi Figueira

Luís Augusto

71	476647	CONCENTRADOR DE OXIGENIO - DESCRICAO: CONCENTRADOR, de Oxigenio, equipamento estacionario para oxigenoterapia e nebulizacao em um so equipamento. destina-se a fornecer alta concentracao de oxigenio suplementar a pacientes que necessitam de oxigenoterapia de baixo fluxo. pode ser utilizado de modo continuo em domicilio, hospitais, ambulatorios e clinicas. a interface para suporte de oxigenio pode ser por meio de cateter nasal ou mascara - fornece um volume continuo de ar superoxigenado separando o oxigenio contido no ar ambiente. a saida de ar permite que o equipamento entregue tratamentos de nebulizacao com remedios simultaneamente a entrega de oxigenio. Capaz de entregar pelo menos 90% de pureza de oxigenio. Fluxo de pelo menos entre 0 e 5 litros por minuto (lpm) - Voltagem 220 v - modelo : NCM SH: 9019.20.10 CFOP: 6949 NF - 43441 - Fornecedor: MULT MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - PROC. DE DOAÇÃO SEI : 019.5060.2021.0062167-34 - DOADO PELA OPAS- Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) .	NUCLEO DE MANUTENCAO	24/05/2021	R\$ 6.100,00
130	635400	AUTOCLAVE VERTICAL - DESCRICAO: AUTOCLAVE HOSPITALAR VERTICAL, CAMARA SIMPLES, CAPACIDADE PARA 75 LITROS, CABO DE LIGACAO PARA 110/220 VOLTS. MARCA: STERMAX, NF: 28743 AFM: 19.004.00835/2022 FORNECEDOR: STERMAX, PROCESSO SEI: 019.4975.2022.0142925-58 - SERIE: ST0051689	CME	07/12/2022	R\$ 11.030,00
TOTAL					R\$ 23.230,00


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SPB
Mat. 19.318.338-3


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat. 0099312


Luiz Faria

Paulo

ANEXO VI

RELAÇÃO DOS BENS NÃO LOCALIZADOS

Após a realização dos trabalhos de supervisão e rastreamentos dos bens patrimoniais permanentes do **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, segue relação dos bens não localizados em anexo.

Descrição	Quantitativo	Valor
Mobiliários	2	R\$ 3.932,00
Total		R\$ 3.932,00

Aguardando justificativa da Diretoria do Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa, Tecnologia e Inovação na Gestão Pública – INTS, que é responsável por todos os bens que nela guardam.

Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT

Wilson Santos de Oliveira
Técnico da COPAT - SESAB
Mat. 19.318.338-5

Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932

RELAÇÃO DOS BENS NÃO LOCALIZADOS

Itens	Patrimônio	Descrição	Dt. Aquisição	Valor Aquisição
1	457665	CARRO DE EMERGENCIA - DESCRICAO: CARRO DE EMERGENCIA, TIPO UNIDADE UNIDADE MOVEL.COM AUTONOMIA ELETRICA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA-ARTMED, NF: 1687 AFM: 19.004.00074/2020 FORNECEDOR: ETICA MED	20/04/2020	R\$ 1.966,00
2	457666	CARRO DE EMERGENCIA - DESCRICAO: CARRO DE EMERGENCIA, TIPO UNIDADE UNIDADE MOVEL.COM AUTONOMIA ELETRICA, GARANTIA MINIMA DE 01 ANO. MARCA-ARTMED, NF: 1687 AFM: 19.004.00074/2020 FORNECEDOR: ETICA MED	20/04/2020	R\$ 1.966,00
TOTAL				R\$ 3.932,00


Renilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos da Oliveira
Técnico de COPAT - SESAB
Mat. 19.318.338-5


Luiz Felipe



Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INIS - UPA Leira de Santana
Mat: 009932

ANEXO VII

RELAÇÃO DOS BENS ANALITICOS - INCORPORADOS

Trata – se de bens materias e equipamentos que foram incorporados a carga patrimonial da **UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE FEIRA DE SANTANA (UPA) 24 HORAS**, com 148 (cento e quatorze) itens no valor de R\$ 114.878,00 (cento e quatorze mil oitocentos e setenta e oito reais).


Ronilton Franklin C. Barros
Cad. 19.535.568-7
Técnico/COPAT


Wilson Santos de Oliveira
Técnico de COPAT - SESA
Mat. 19.348.338-5



Paulo
Luiz


Rodrigo Santos
Técnico de Manutenção
INTS - UPA Feira de Santana
Mat: 009932